

# 液态细胞质控品 CK5/6-说明书

## 【产品名称】

液态细胞质控品 CK5/6-

## 【包装规格】

货号	规格	适用靶标	应用方式
I32372A	100 $\mu$ L/瓶	CK5/6	手工
I32372B	500 $\mu$ L/瓶	CK5/6	LYNX480 PLUS 或手工

## 【预期用途】

用于免疫组织（细胞）化学染色中的阳性对照或阴性对照。

## 【检测原理】

液态细胞质控品含有目的蛋白，且具有完整的细胞核、细胞膜、细胞浆等亚细胞结构，在免疫组化染色中与待检组织切片可保持一致的表达模式。作为非定值质控品使用，可监测免疫组化检测流程。其中阳性对照不仅可以显示阳性染色，还可以对阳性亚细胞定位做进一步的对照；不表达目的蛋白的液态细胞质控品可用作阴性对照。为后续免疫组织化学染色结果提供更好判断依据。

## 【主要组成成分】

本品为底层白色沉淀，上层澄清液体，主要组成成分为细胞、乙醇和纯化水。

## 【储存条件及有效期】

储存条件：-25 $^{\circ}$ C ~ -18 $^{\circ}$ C，有效期18个月。

生产日期、有效期至：见标签。

## 【样本要求】

石蜡包埋的组织蜡块，切成3-4 $\mu$ m厚的石蜡片，捞片后进行烤片30min，避免蜡液在玻片空白处大面积扩散。样本组织切片制备后保存条件为避光、室温，但为了良好地重现组织中抗原分布情况，要在30天内完成检测。

## 【适用一抗克隆号】

BP6021&BP6065；BP6252。

## 【检验方法】

1.以手工滴加液态细胞质控品为例，使用混匀仪将液态细胞质控品充分混匀成均一细胞悬液；

备注：均一悬液指无肉眼明显可见的颗粒状物质，内容物成均一的混合物。

2.使用10 $\mu$ L移液器吸取混匀后的阳性或阴性液态细胞质控品CK5/6悬液滴在每张待检组织切片玻片空白无蜡处，左右各选择1-2处，每处滴加约1.5 $\mu$ L左右悬液，室温晾干；进行后续免疫组织化学染色，若在免疫组化仪上进行实验，则按照对应仪器的操作规程进行免疫组织化学染色；若使用手工方法进行实验，则按如下常规步骤进行免疫组织化学染色。

3.将点好液态细胞质控品的石蜡切片进行烤片，烤片温度约60 $^{\circ}$ C，时间约60min，随后切片经常规脱蜡和水化后，清洗切片。

4.组织抗原热修复：根据对应的免疫组织化学一抗试剂说明书进行组织抗原修复。

5.将切片放入盛有过氧化物酶阻断剂的染色缸中浸泡10分钟。

6.画圈：用免疫组化笔圈定玻片上的待测组织区域及液态细胞质控

品滴加区域，随后放入PBST缓冲液中。

7.一抗孵育：根据抗体说明书的要求进行一抗的孵育

8.二抗孵育：根据二抗说明书要求进行二抗的孵育；

9.DAB显色：DAB现配现用，显色时间控制在2-5分钟。

10.苏木素染液复染，切片经过脱水，透明，封片。

备注：若使用LYNX480 PLUS滴加对应货号产品，根据仪器设置进行操作即可。


## 【检验结果的解释】

参考以下内容进行结果判定：

显微镜下观察染色情况：

（1）液态细胞质控品 CK5/6-的每个点样处中的细胞存在小于 3%的染色，判为阴性。

液态细胞质控品 CK5/6-染色图片（40 $\times$ ）如下：

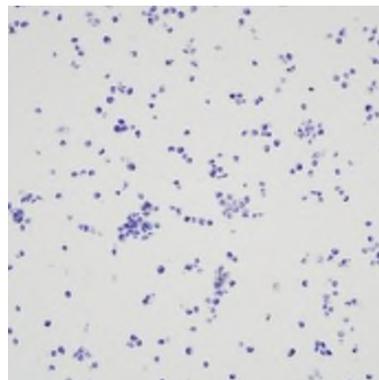

液态细胞质控品 CK5/6-染色结果图

符合上述（1）点要求，表明本次实验过程无误，质控品所在切片样本结果可进行诊断判读。

备注：（1）同一张切片上在细胞质控品点样位置任何一处染色出现异常，表明本次实验过程异常。导致实验异常的原因可能有：抗原修复不当；抗体试剂浓度较低或较高；抗体试剂过期；加样不均匀；细胞质控品点样位置选择不当等。

（2）由于市面不同品牌型号玻片表面工艺不同，若遇质控品滴加后形态不佳的情况，可作如下处理：

（a）先进行组织切片捞片操作，捞片时将玻片表面与水进行充分接触；烤片后，滴加本质控品。

（b）玻片直接接触水面。烘干后，滴加本质控品。

（3）阴性液态细胞质控品中可能存在少量非细胞的颗粒染色，不判读为阳性细胞。

## 【检验方法的局限性】

1.液态细胞质控品密度、点样晾干程度、实验操作等任一环节的不规范操作都有可能影响最终的实验结果。


2.专业的操作人员、经过认证的实验室将有助于实现检测过程的标准化，从而减少由于各种外界因素造成的染色偏差。

3.必须由有经验的病理专家对细胞的染色定位进行评估。

## 【注意事项】

- 1.本产品用于科学研究，不用于临床诊断。
- 2.本产品为非定值质控品。
- 3.开始实验前，应仔细阅读此说明书。
- 4.请在试剂有效期内使用。
- 5.本试剂仅限有专业经验或经专业培训的人员使用。
- 6.避免试剂接触眼睛和粘膜，如接触到敏感区域，立即用大量清水冲洗。
- 7.采用适当的防护措施，比如操作者穿戴乳胶手套、口罩、护目镜、实验服等进行安全操作。

**【标识的解释】**

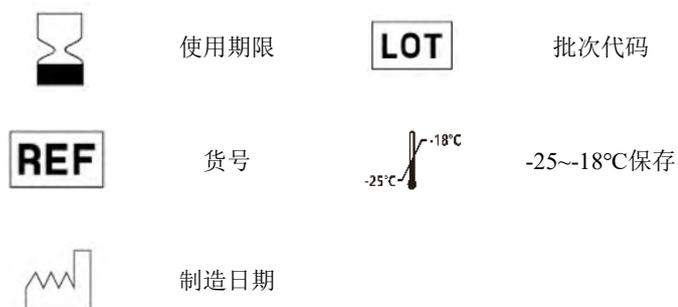

**【参考文献】**

- 1.刘汉忠，张平安，等.临床和实验医学杂志,2013,12(2):128-129.
- 2.中华医学会.《临床技术操作规范·病理学分册》.人民军医出版社,2004.

**【基本信息】**

生产企业：图凌（杭州）生物医药有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路 688 号 5 幢 1702 室

联系电话：0571- 88177683 传真：0571- 88177681

售后服务单位：图凌（杭州）生物医药有限公司

联系方式：0571- 88177683

生产地址：浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路 688 号 5 幢 1702 室